



Σύντομος Οδηγός
Medtrum EasyPatch App

Επεξήγηση σημείων αρχικής οθόνης

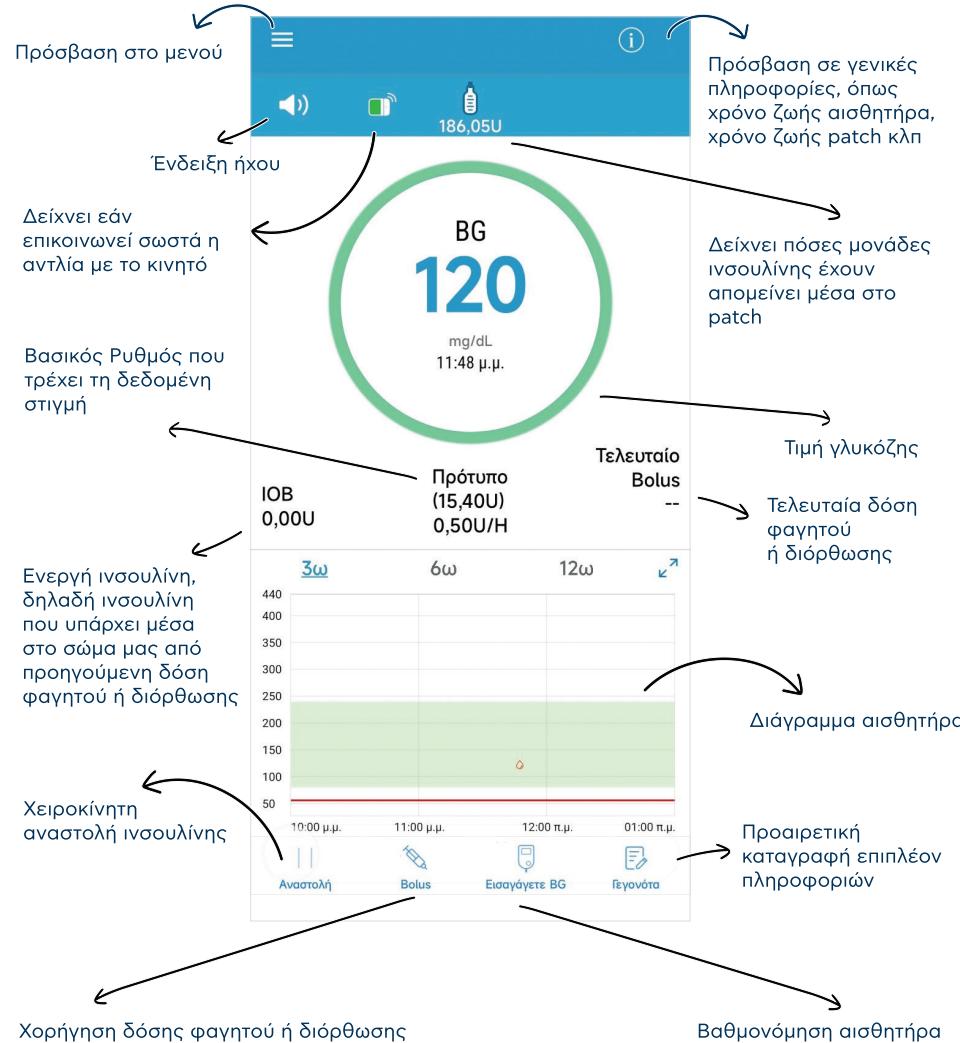


Πώς να τοποθετήσετε ένα νέο patch

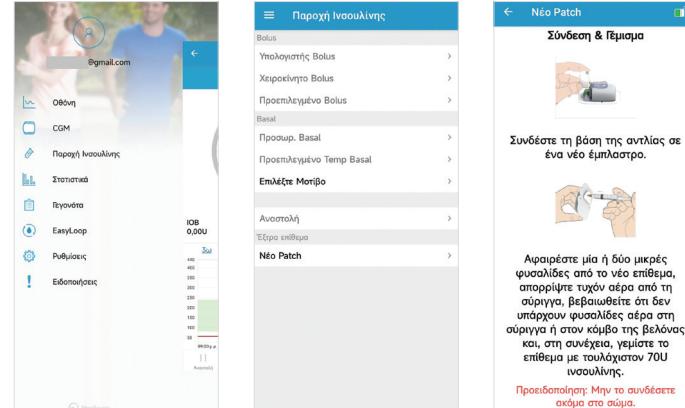

- 1 Επιλέξτε από τις 3 παύλες "Παροχή Ινσουλίνης"
- 2 Επιλέξτε "Νέο Patch"
- 3 Συνδέστε τη βάση της αντλίας με το νέο patch. Πρέπει να ακουστούν 4 ηχητικές ενδείξεις.

Γεμίστε τη σύριγγα με ινσουλίνη και αφαιρέστε τον αέρα. Έπειτα, χρησιμοποιήστε τη σύριγγα για να αφαιρέσετε τον αέρα μέσα από το patch.

Γεμίστε το patch με την ινσουλίνη.

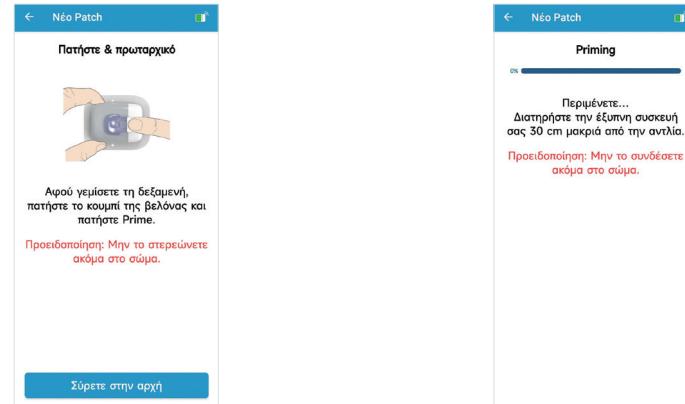

- 4 Πατήστε το κουμπί της βελόνας έως τη μωβ ασφάλεια.
 - 5 Καθαρίστε το σημείο της τοποθέτησης με οινόπνευμα και γάζα.
- Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρετοιμασίας του patch.


Πώς να τοποθετήσετε ένα νέο patch (συνέχεια)



6

Αφαιρέστε τη μωβ ασφαλία σύροντας προς τα έξω. Αφαιρέστε τα δύο αυτοκόλλητα, ξεκινώντας από αυτό που έχει το λευκό πλαστικό. Εφαρμόστε την αντλία στο σημείο που καθαρίσατε, πιέζοντας στο κέντρο για 5 δευτερόλεπτα. Αφήστε χαλαρό το patch επάνω στο δέρμα και κολλήστε το υπόλοιπο αυτοκόλλητο. Πατήστε το κουμπί του καθετήρα.

Επιλέξτε **συνέχεια**

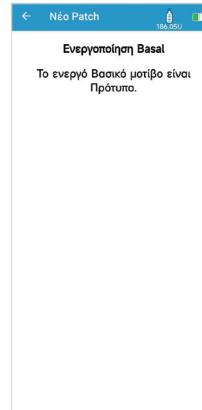

7


Ενεργοποίηση basal.

Πώς να χορηγήσετε μια bolus δόση (φαγητό ή διόρθωση)



1


Από την αρχική οθόνη επιλέξτε **"Bolus"**

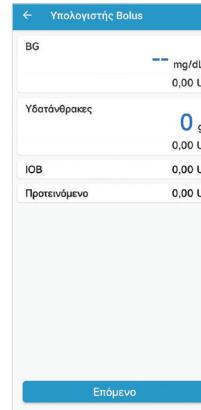

2


Εισάγετε την τιμή του σακχάρου και τα γραμμάρια υδατανθράκων (εφόσον υπάρχει γεύμα).

Επιλέξτε **"Επόμενο"**

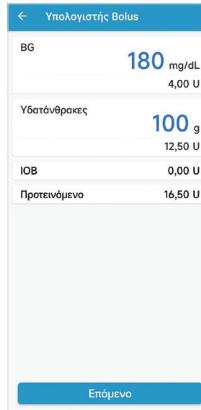


Επόμενο

Πώς να απενεργοποιήσετε ένα patch και να κάνετε αλλαγή

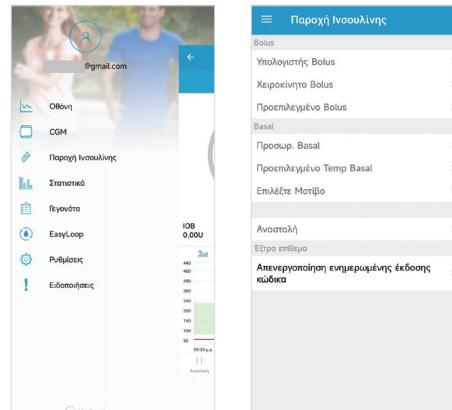

1

Επιλέξτε από τις 3 παύλες **"Παροχή Ινσουλίνης"**

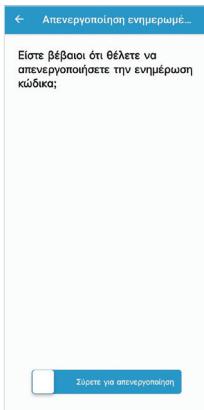

2


Επιλέξτε **"Απενεργοποίηση ενημερωμένης έκδοσης κώδικα"**

3

Επιλέξτε **"Σύρετε για απενεργοποίηση"**

Ακολουθήστε ξανά τη διαδικασία τοποθέτησης νέου patch από την αρχή.

4

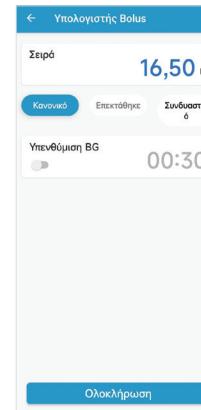


3

Αφού ελέγχετε την προτεινόμενη δόση, επιλέξτε **"Ολοκλήρωση"**



4

Επιλέξτε **"Σύρετε για παροχή"**

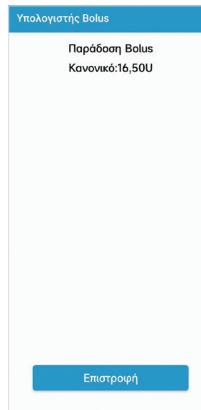


5

Επιλέξτε **"Επιστροφή"**

5

Πώς να ρυθμίσετε έναν προσωρινό βασικό ρυθμό

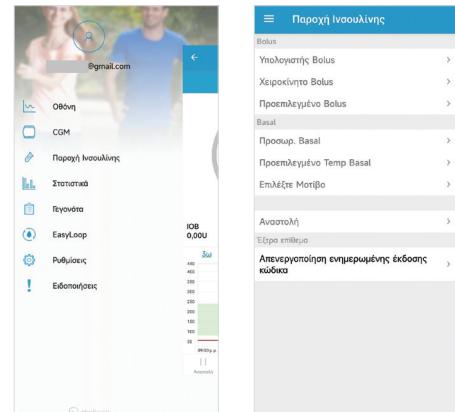


1
Επιλέξτε από τις 3 πάνιλες "Παροχή Ινσουλίνης"

2
Επιλέξτε "Προσωρινό Basal" ή "Temp Basal"



3
Επιλέξτε την αλλαγή σε % που χρειάζεται να κάνετε.

4
Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια.

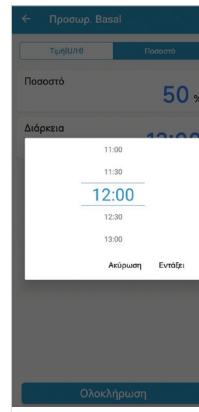

Πώς να κάνετε χειροκίνητη αναστολή και επανέναρξη της χορήγησης ινσουλίνης

ΑΝΑΣΤΟΛΗ

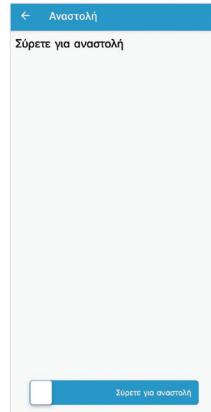
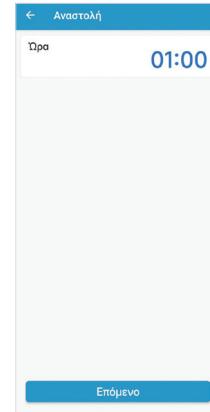


1
Επιλέξτε "Αναστολή"

2
Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια της αναστολής.

3
Επιλέξτε "Επόμενο"



4
Επιλέξτε "Σύρετε για αναστολή"

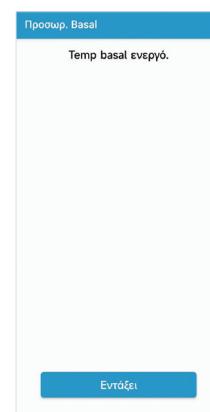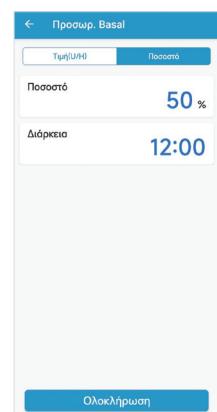

5
Επιβεβαιώστε τις τιμές που έχετε εισάγει και επιλέξτε "Ολοκλήρωση"

6
Επιλέξτε "Σύρετε για να ξεκινήσετε το temp basal"

7
Επιλέξτε "Εντάξει"

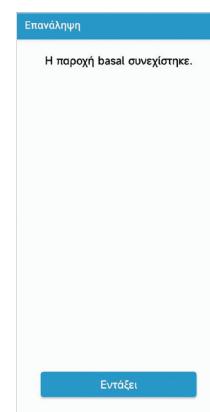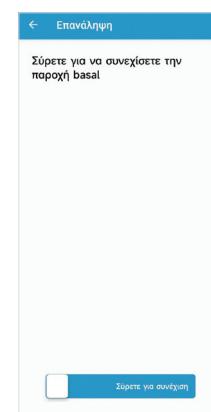

1
Επιλέξτε "Επανάληψη"

2
Επιλέξτε "Σύρετε για συνέχιση"

3
Επιλέξτε "Εντάξει"



ΔΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ!

Για όλους εμάς στην Eifron, ο άνθρωπος είναι στην καρδιά του ενδιαφέροντός μας! Παρέχουμε πλήρη εκπαίδευση για τα προϊόντα μας, με βάση τα διεθνή πρότυπα. Η ομάδα μας παρέχει τεχνική υποστήριξη 24/7, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλότερη μετάβαση σε κάθε σύστημα.

Σημαντικά Τηλέφωνα για Χρήστες των Συστημάτων Medtrum
(Πα ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη)

Τεχνική Υποστήριξη (24/7)

Κλήση από κινητό
ή σταθερό:
694 999 1111

Εξυπηρέτηση Πελατών

(Άυλα Barcode & Αποστολές
Αναλωσίμων)
Δευτέρα – Παρασκευή
08:00 – 16:00
2310 464 000

Φροντίδα Ασθενών Medtrum

(Αντικαταστάσεις – Επιστροφές
Προϊόντων)
Δευτέρα – Παρασκευή
09:00 – 17:00
2310 461 000 (εσ. 5)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη

Λεωφόρος Γιολγύρου 32, Θέρμη
2310 461 000
2310 464 000

Αθήνα

Ακακιών 52,
Εμπορικό Κέντρο Πολύδροσο

info@eifron.com

www.eifron.com